INFRATRONIC SOLUTIONS
we think globally

Originalanleitung
Spendersystem
EURO-2 Serie

ANLEITUNG Flaschenwechsel

Spender IT 1000 AW EURO-2 und IT 500 AW EURO-2

1. Es ist empfohlen bei der Aufbereitung von Spendern und Pumpen Handschuhe zu tragen.
(In Anlehnung an die TRBA 250, Punkt 4)



2. Gerät öffnen und ggf. Anhaftungen an der Auslassdüse entfernen und desinfizieren*. Kontaminationsschutz der Spenderrückwand entnehmen und auf die Auslassdüse der Schlauchdosierpumpe stecken. * Bei Seife

3. Leeres Gebinde inkl. Pumpen-Adapter-Kombination und keimarmer Flaschenbelüftung herausnehmen.

4. PAK mit Ein- und Ausdrehhilfe vom leeren Gebinde drehen und direkt auf neues Gebinde schrauben.

5. Kontaminationsschutz entfernen, Schlauchdosierpumpe über dem Waschbecken entlüften und Kontaminationsschutz wieder aufstecken.

6. Gebinde mit Kontaminationsschutz im Spender platzieren und Sichtprüfung auf Dichtheit durchführen.

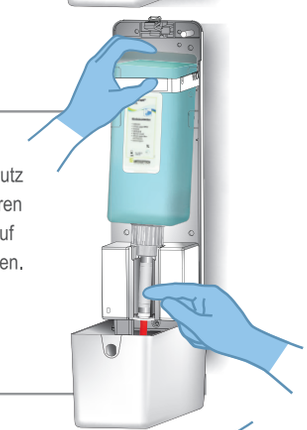

7. Einstichstelle der keimarmen Flaschenbelüftung auf dem Flaschenboden mit Desinfektion desinfizieren.

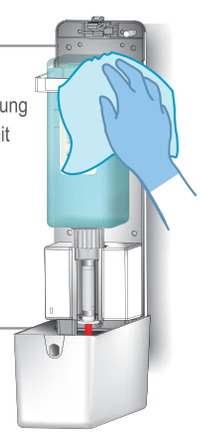

8. Keimarme Flaschenbelüftung aus dem leeren Gebinde herausziehen und in eine der vorderen, äußersten Ecken des Flaschenbodens einstechen.



9. Spender schließen, Kontaminationsschutz von der Auslassdüse ziehen und auf dem Pin der Spenderrückwand oben rechts stecken.

INFRATRONIC SOLUTIONS Herstellerempfehlung:
- Bei Desinfektion einmal pro Jahr die Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung wechseln.
- Bei Seife zweimal pro Jahr die Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung tauschen.

Art.Nr. 10120 Version 20200421

Weinmann GmbH | INFRATRONIC SOLUTIONS
Frankenstrasse 6 | D-63776 Mömbris

Ihnen gefällt das Produkt? Dann zeigen Sie es einfach jedem und klicken Sie bei Facebook auf „Gefällt mir“!